

1998年3月26日

検査成績書

浜松ホトニクス株式会社
固体事業部 第30部門

型名 ATLAS-10X10 1564

判定

合

責任者

澤井

検査員

岩

数量 1式

備考

受注品、サンプル品、その他分納、完納

1. 以下に1式(20個)のサンプルNo.と条件を示します。

ウェハー条件	チップ品	ベース組立品	
		樹脂はみ出し無し	樹脂はみ出し有り
①	1-5, 1-6	1-1	1-3
②	4-5, 4-6	4-1	4-3
③	7-  7- 	7-4	7-5
④	10-5, 10-6	10-1	10-3
⑤	13-5, 13-6	13-2	13-3

2. チップ品の暗電流データを以下に示します。

サンプル No	VR=100V	VR=200V
1-5	0.477nA	0.671nA
1-6	0.483nA	0.679nA
4-5	2.01nA	54.7nA
4-6	2.05nA	69.0nA
7-1 2	16.9nA	2390nA
7-1 3	13.4nA	2850nA
10-5	0.895nA	1.44nA
10-6	0.947nA	1.53nA
13-5	0.390nA	0.549nA
13-6	0.392nA	0.550nA

3. ベース組み立て品IVデータ


それぞれのサンプルのデータを2/6項から6/6項に示します。

検査日

1998年 3月 26日

25℃

様式K30-2017

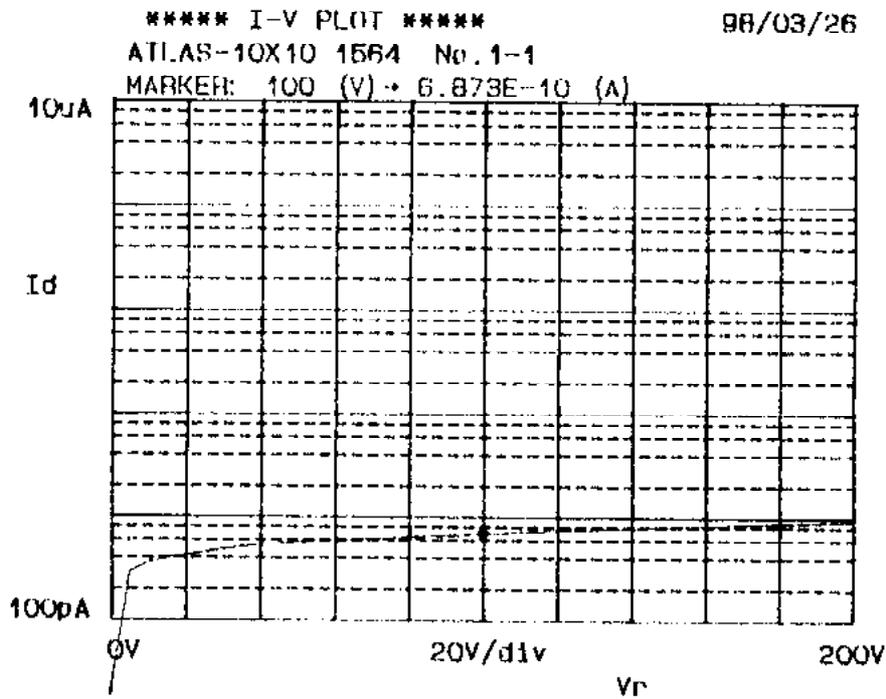

SWEEP ==== linear

START ==== 0 (V)

STOP ===== 200 (V)

STEP ===== 5 (V)

NUMBER === 41

